

Экземпляр №1 из 2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
ООО «НТЦ «Фотометрия»
А.В. Овчинников
подпись
11 октября 2018 г.



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 348-18/св
ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА
LPR-100-6500K-M SMD PRO
(на 8 листах)

*Результаты измерений, представленные в настоящем протоколе,
распространяются только на измеренные образцы.*

*Любая публикация или частичное воспроизведение содержания протокола ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного
разрешения ООО «НТЦ «Фотометрия».*



1. Основные сведения об образце:

Наименование образца: Светодиодный светильник
Тип (модель): LPR-100-6500K-M SMD PRO
Заводской номер (условный номер): зав.№ б/н усл. № 18-449
Напряжение электропитания, В 100-270
Частота электропитания, Гц 50/60

2. Сведения об отборе образца:

Дата получения образца 02 октября 2018 г.
Дата проведения измерений 10 октября 2018 г.

3. Заявитель:

Название организации: ООО «ЭнТи Сервис»
Юридический адрес: 125009, город Москва, Тверская улица, дом 20, строение 3, 3-й этаж, помещение № 10
Телефон: 8 (495) 664 68 97

4. Изготовитель:

Название организации: АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО. ЛТД
Юридический адрес: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Телефон: не указан

5. Место проведения измерений:

Название организации (полное): Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Фотометрия»
Название организации (сокращенное): ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия»
Аттестат аккредитации: RA.RU.21ГГ01
Юридический адрес: 107140, г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 3, пом. 1, комн. 13
Телефон: 8 (495) 223-32-85
E-mail: ntc@fotometriya.ru

6. Документация, представленная с образцом:

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

7. Краткое описание образца:

Светильник LPR-100-6500K-M SMD PRO со светодиодными источниками света,
источник питания встроен в корпус светильника.

8. Измеряемые характеристики:

Диаграмма пространственного распределения силы света в необходимом количестве плоскостей, световой поток, эффективность, коррелированная цветовая температура, индекс цветопередачи, электрические характеристики.



9. Процедура измерений.

9.1. Условия проведения измерений:

Светотехнические измерения осветительных приборов выполняют в помещении с неподвижным воздухом при отсутствии дыма и пыли, а также при выполнении следующих условий:

- тёмная комната без посторонних засветок;
- коэффициент отражения поверхностей <0,015;
- температура окружающего воздуха +25±2 °C;
- относительная влажность воздуха 45-80 %;
- атмосферное давление 97,0-105 кПа

9.2. Цель измерений:

Проведение светотехнических и электрических измерений.

9.3. Программа измерений:

В соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;
ГОСТ Р 55703-2013 «Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых характеристик».
ГОСТ Р 55702-2013 «Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров»

9.4. Нормы, критерии оценки и методы измерений:

ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;
ГОСТ Р 55703-2013 «Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых характеристик».
ГОСТ Р 55702-2013 «Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров»

9.5. Идентификация образца:

Наименование, тип, маркировка и назначение образца соответствуют сопроводительной документации.

9.6. Проверка работоспособности:

Работоспособность соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду образца.



10. Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ).

Таблица 1

Наименование	Тип	Зав. №, Инв. №	Погрешность, класс точности	Свидетельство о поверке, протокол аттестации		Срок очередной поверки (аттестации)
				Номер	Дата	
1	2	3	4	5	6	7
Установка для измерений силы света и его пространственного распределения	ГФУ-23	инв. № 0001	$\pm 2,5 \%$	СК 0157982	09.06.2017 г.	08.06.2019 г.
Двухкоординатный гониометр	ДГ-360	инв. № 0029	Вертикальный: $\pm 0,04^\circ$ Горизонтальный: $\pm 0,02^\circ$	СК 0157981	09.06.2017 г.	08.06.2019 г.
Фотодатчик (фотометрическая головка)	ГФ6-1	зав.№ 1109, инв.№ 0098	$\pm 3,0 \%$	СК 0157594	03.11.2017 г.	02.11.2018 г.
Измеритель электрической мощности	GPM-8212	зав.№ CL220076, инв.№ 0027	$U: \pm (0,001U + 0,001U_k);$ $I: \pm (0,001I + 0,001I_k);$ $P: \pm (0,002P + 0,002P_k);$ $f: \pm (0,002F + 2м);$ $\cos\varphi: \pm 0,010$	СП 1752265	24.10.2017 г.	23.10.2018 г.
Источник питания переменного тока	APS-9501	зав.№ GEN852710, инв.№ 0025	$U: \pm (1\% + 0,1В);$ $I: \pm (1\% + 5мА) - \text{на пределе } 2А;$ $f: \pm 0,1Гц;$ $P: \pm (1,5\% + 0,5Вт) - \text{на пределе } 360Вт;$ $\cos\varphi: \pm (2\% + 0,002)$	СП 1825424	20.11.2017 г.	19.11.2018 г.
Барометр-Анероид	БАММ-1	зав.№ 441, инв.№ 0020	$\pm 0,2 \text{ кПа}$	СП 1876400	05.12.2017 г.	04.12.2018 г.
Гигрометр психрометрический	ВИТ-2	зав.№ У736, инв.№ 0130	Температура: $\pm 0,2^\circ\text{C};$ Относит. влажность: $\pm 6\% - \text{при температуре сухого термометра от } 10 \text{ до } 30^\circ\text{C}.$	Паспорт №У736	24.10.2016 г.	23.10.2018 г.
Спектроколориметр	ТКА-ВД/2	зав.№ 72050 инв. № 0097	Освещенность: $\pm 10\%;$ координаты цветности: $\pm 0,005$ (для тепловых источников) и $\pm 0,02$ (др. ИС со сплошным спектром излучения); коррелированная цветовая температура: $\pm 5\%$	СП 1857383	07.12.2017 г.	06.12.2018 г.
Люксметр-яркомер-пульсметр	«Эколайт» (мод.01)	ФГ-01 зав.№ 00644-12, БОИ-01, зав.№ 00243-11, инв.№ 0024	Освещенность $E: \pm 8\%;$ Яркость $L: \pm 10\%;$ Коэффициент пульсации $k: \pm 10\%$	СП 1789902	18.10.2017	17.10.2018

Примечание:

Оборудование, не вошедшее в Таблицу 1, необходимое для измерений приведено в Паспорте ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия».



11. Результаты измерений:

Результаты измерений приведены в Таблице 2 и в Приложении 1.
Фотографии образца в Приложении 2.


Таблица 2

Название параметра, обозначение, ед. измерения		Результаты
1. Фотометрические параметры		
1.1. Суммарный световой поток, Φ_{Σ} , лм		8 219
1.2. Класс светораспределения		-
1.3. Тип условной экваториальной кривой силы света		-
1.4. Тип кривой силы света	Плоскость C_0	-
	Плоскость C_{90}	-
1.5. Осевая сила света, I_{v0} , кд		-
1.6. Максимальная сила света, I_{vmax} , кд		-
1.7. Габаритная яркость, L_A , кд/м ²		-
1.8. Коэффициент пульсации освещенности, к, %		-
1.9. Коррелированная цветовая температура, $T_{кц0}$, К		5 938
1.10. Индекс цветопередачи, R_{a0}		85
2. Электрические параметры		
2.1. Напряжение электропитания, U_0 , В		230
2.2. Частота электропитания, f, Гц		50
2.3. Потребляемая мощность, P, Вт		95,6
2.4. Потребляемый ток, I, мА		429,7
2.5. Коэффициент мощности		0,966
3. Обобщенные параметры		
3.1. Световая отдача светильника, η , лм/Вт		86,0

Примечание:

- U_0 - Напряжение, равное номинальному или согласованному напряжению электропитания, В;
 $T_{кц0}$ - Коррелированная цветовая температура по осевой, К;
 R_{a0} - Индекс цветопередачи по осевой.

Диаграмма цветности x,y МКО-1931

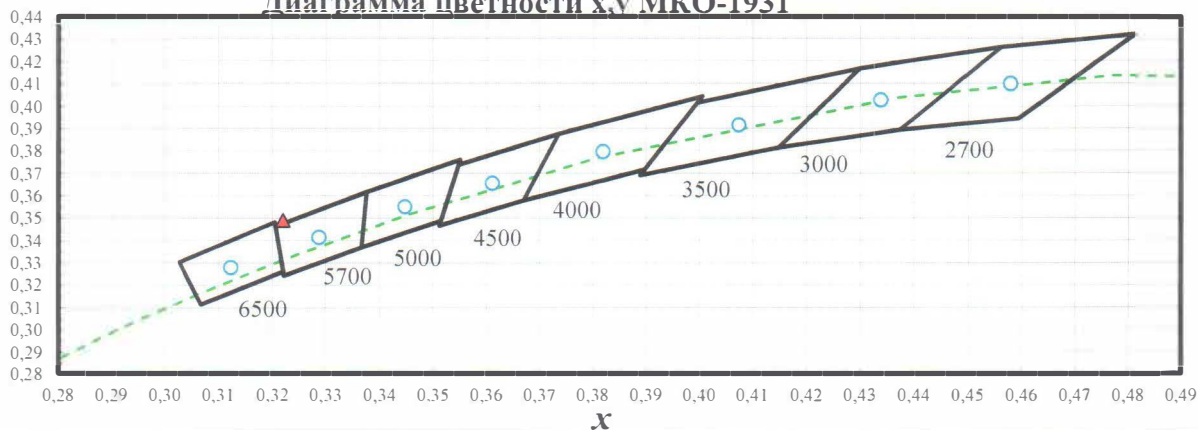

▲ Источник	--- Планка locus	— Допустимые отклонения КЦТ	○ Тки
------------	------------------	-----------------------------	-------

Инженер-испытатель

П.В. Старшинов



Приложение 1

Диаграмма пространственного распределения силы света образца в полярных координатах:

Светодиодный светильник

LPR-100-6500K-M SMD PRO ,

зав.№

б/н

усл. № 18-449


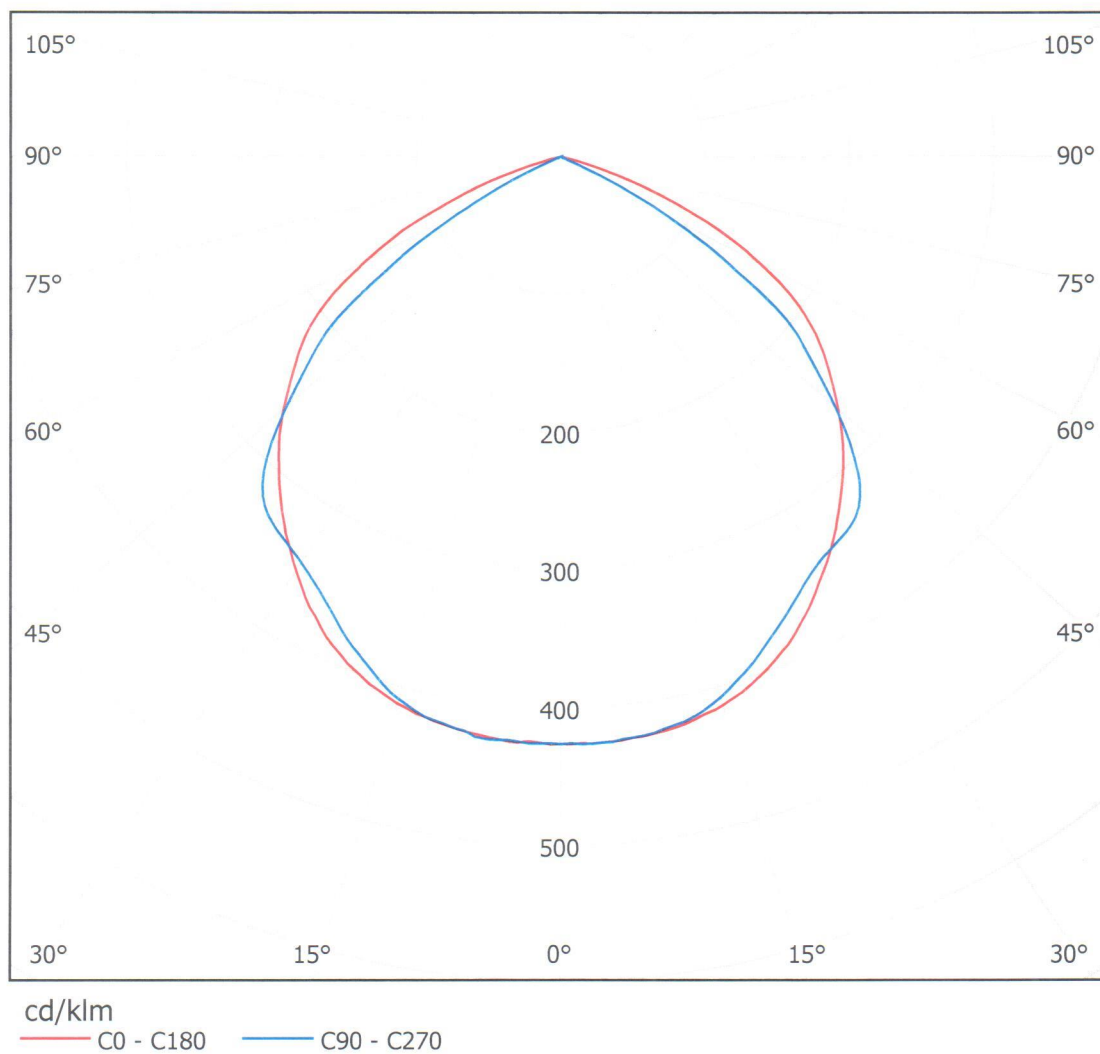




Диаграмма пространственного распределения силы света образца в декартовых координатах:
Светодиодный светильник LPR-100-6500K-M SMD PRO , зав.№ б/н усл. № 18-449

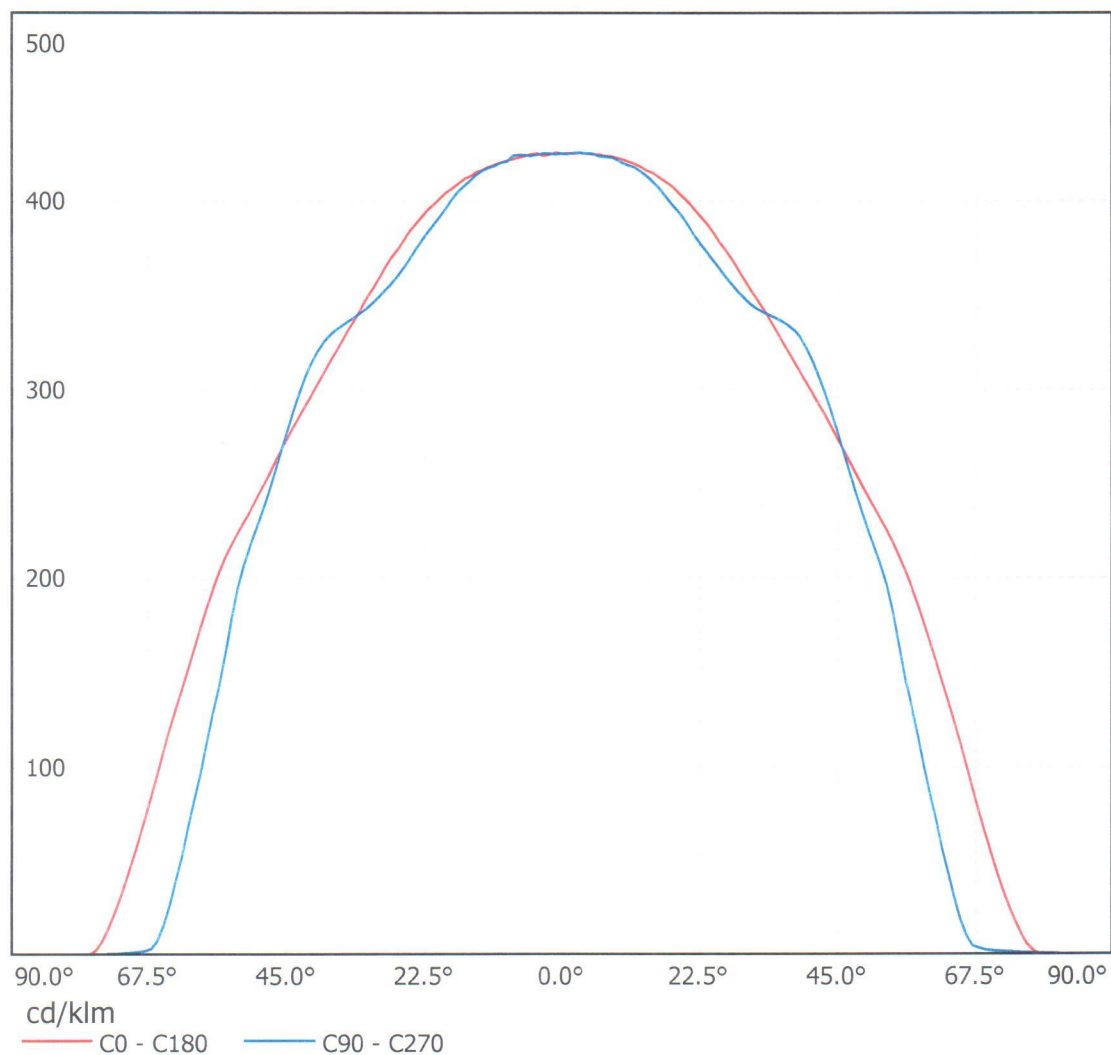

Примечание:

Измерение проводилось в фотометрической системе С_γ по ГОСТ Р 54350-2015:

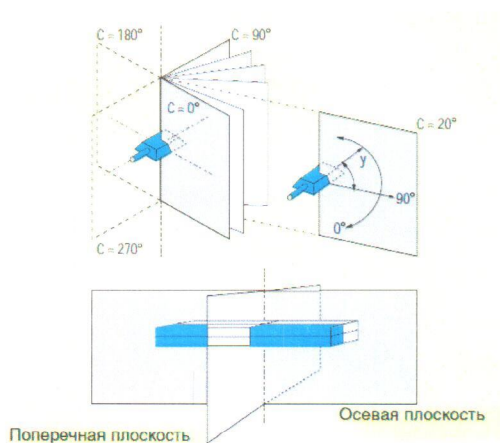


Рисунок 1



Приложение 2



СВЕТОДИОДНЫЙ
ПРОЖЕКТОР

Модель: LPR-100-6500K-M SMD PRO



Напряжение питания: 100-270В~ (50/60Гц)

Мощность: 100Вт

Степень защиты оболочки: IP65

Изготовлено в Китае

Дата производства: 03.2017



Светодиодный светильник

Фотография 1
LPR-100-6500K-M SMD PRO

зав.№ б/н

усл. № 18-449



Светодиодный светильник

Фотография 2
LPR-100-6500K-M SMD PRO

зав.№ б/н

усл. № 18-449